

清掃と消毒

ローター、ラックが汚れた場合は、下記の方法で清掃、消毒を行なってください。

ローター、バケット、ラックの清掃

① ローター、バケット、ラックを遠心機から取り外す。

② 約50°Cのぬるま湯で洗う。


- ・汚れが落ちにくい時には中性洗剤を使用してください。
- ・腐食の原因になりますので中性洗剤以外は使用しないでください。

③ 蒸留水ですすぐ。

④ 柔らかい布等で水分を拭き取り、乾燥させる。



重要

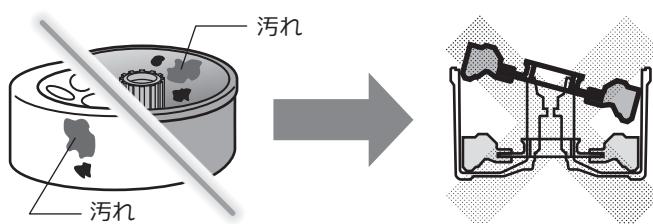

※ローター・ラックに付着した汚れが斜め架けの原因となり、重大な事故につながる恐れがあります。
定期的にローター・ラックをご確認いただき、清潔な状態を保つようにしてください。

ローター、バケット、ラックの消毒

① ガス滅菌やエタノール消毒を行う。

- ・ローター、バケットは100°C以上に加熱すると腐食や破損がおきる恐れがあります。
- ・個別の取扱説明書がある場合は、そちらに従ってください。